



安特检测
ANTE TESTING

正本

检测报告

报告编号: RH20240401025

项目名称

注意事项

- 1、报告无“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效:报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责:检测条件和

山东安特检测有限公司 检测报告

第 1 页 共 5 页

委托单位	山东万达化工有限公司
委托人	孙继鹏
受检单位	山东万达化工有限公司

受检单位地址

山东省东营市垦利区永莘路 68 号

委托时间


2024 年 03 月 23 日

完成时间

2024 年 05 月 22 日

检测类别

委托

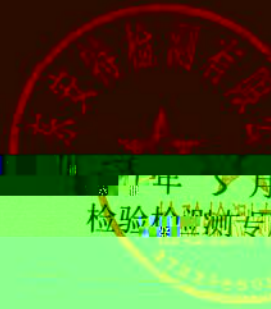

2024 年 5 月

检验合格

28 日

盖章

1. 项目背景

2. 项目目标

3. 项目范围


4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目风险

7. 项目总结

序号	任务名称	开始时间	结束时间	负责人	状态
1	需求分析	2024-01-15	2024-01-25	张三	完成
2	系统设计	2024-01-25	2024-02-15	李四	进行中
3	开发实现	2024-02-15	2024-03-15	王五	进行中
4	测试部署	2024-03-15	2024-03-30	赵六	待开始
5	项目总结	2024-03-30	2024-04-05	张三	待开始

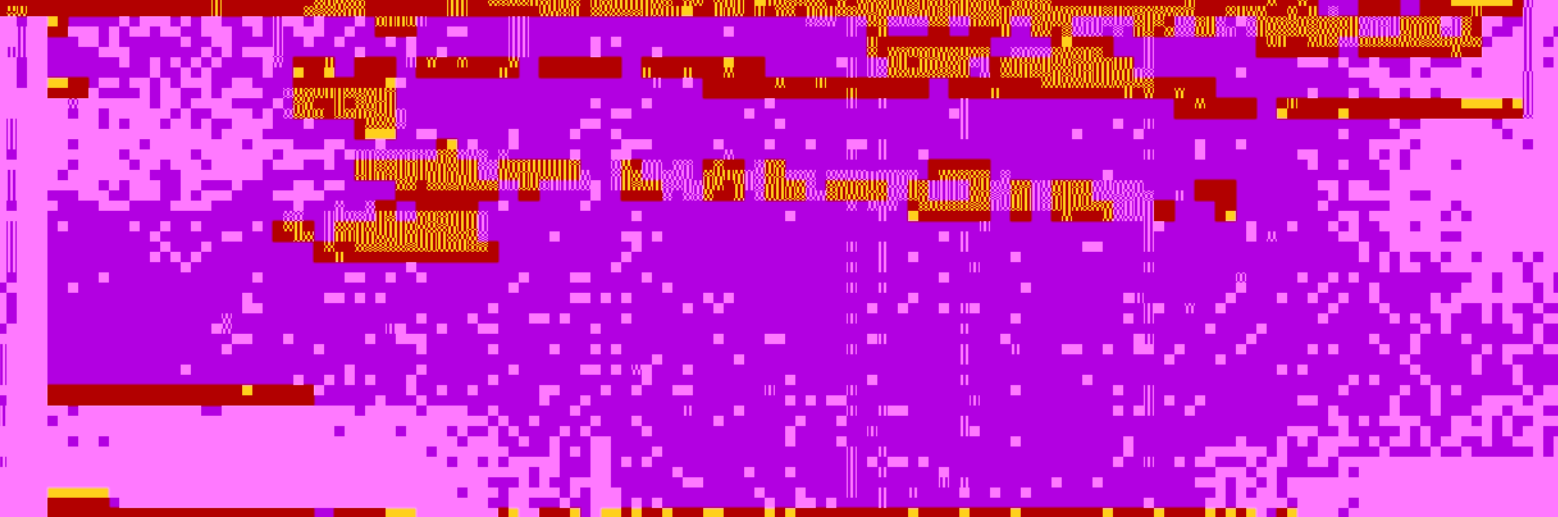

山东安特检测有限公司 检测报告

表 4-1 废水 (COD)

序号	检测项目	检测日期	检测结果	标准限值
1	COD	2024-04-01	120	150
2	COD	2024-04-02	110	150
3	COD	2024-04-03	130	150
4	COD	2024-04-04	140	150
5	COD	2024-04-05	150	150
6	COD	2024-04-06	160	150
7	COD	2024-04-07	170	150
8	COD	2024-04-08	180	150
9	COD	2024-04-09	190	150
10	COD	2024-04-10	200	150
11	COD	2024-04-11	210	150
12	COD	2024-04-12	220	150
13	COD	2024-04-13	230	150
14	COD	2024-04-14	240	150
15	COD	2024-04-15	250	150
16	COD	2024-04-16	260	150
17	COD	2024-04-17	270	150
18	COD	2024-04-18	280	150
19	COD	2024-04-19	290	150
20	COD	2024-04-20	300	150
21	COD	2024-04-21	310	150
22	COD	2024-04-22	320	150
23	COD	2024-04-23	330	150
24	COD	2024-04-24	340	150
25	COD	2024-04-25	350	150
26	COD	2024-04-26	360	150
27	COD	2024-04-27	370	150
28	COD	2024-04-28	380	150
29	COD	2024-04-29	390	150
30	COD	2024-04-30	400	150



口物仪器测量范围

mg/L

样品编号

仪器测
试时间

自动仪器测
定值 (mg/L)

标准样品浓
度 (mg/L)

绝对
误差

标准
偏差

仪器编号

样品编号	仪器测 试时间	自动仪器测 定值 (mg/L)	标准样品浓 度 (mg/L)	绝对 误差	标准 偏差	仪器编号
1	2021-01-01 10:00	10.5	10.0	0.5	0.2	001
2	2021-01-01 10:05	10.2	10.0	0.2	0.1	001
3	2021-01-01 10:10	10.8	10.0	0.8	0.3	001
4	2021-01-01 10:15	10.1	10.0	0.1	0.1	001
5	2021-01-01 10:20	10.6	10.0	0.6	0.2	001
6	2021-01-01 10:25	10.3	10.0	0.3	0.1	001
7	2021-01-01 10:30	10.7	10.0	0.7	0.3	001
8	2021-01-01 10:35	10.4	10.0	0.4	0.2	001
9	2021-01-01 10:40	10.9	10.0	0.9	0.4	001
10	2021-01-01 10:45	10.2	10.0	0.2	0.1	001
11	2021-01-01 10:50	10.6	10.0	0.6	0.2	001
12	2021-01-01 10:55	10.3	10.0	0.3	0.1	001
13	2021-01-01 11:00	10.7	10.0	0.7	0.3	001
14	2021-01-01 11:05	10.4	10.0	0.4	0.2	001
15	2021-01-01 11:10	10.8	10.0	0.8	0.3	001
16	2021-01-01 11:15	10.1	10.0	0.1	0.1	001
17	2021-01-01 11:20	10.5	10.0	0.5	0.2	001
18	2021-01-01 11:25	10.2	10.0	0.2	0.1	001
19	2021-01-01 11:30	10.6	10.0	0.6	0.2	001
20	2021-01-01 11:35	10.3	10.0	0.3	0.1	001
21	2021-01-01 11:40	10.7	10.0	0.7	0.3	001
22	2021-01-01 11:45	10.4	10.0	0.4	0.2	001
23	2021-01-01 11:50	10.8	10.0	0.8	0.3	001
24	2021-01-01 11:55	10.1	10.0	0.1	0.1	001
25	2021-01-01 12:00	10.5	10.0	0.5	0.2	001

山东安特检测有限公司 检测报告

附件 1: 在线数据照片

